

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

D O D A T O K č. 1

zo dňa 08.07.1996

k Rozhodnutiu č. 1159/92/1 zo dňa 17.04.1992, ktorým sa vydalo

SCHVÁLENIE TYPU MERADLA

pre meradlo s úradnou značkou schváleného typu

TCS 128/92-1159

Na žiadosť firmy NOVUM SK, spol. s r.o., Svätoplukova 3, 821 09 Bratislava, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 a § 12 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č.1, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla - váh na počítanie kusov Digital Counting Scale, model DC - 80 ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohoto Dodatku.

Výrobca: TERAOKA WEIGH-SYSTEM PTE. LTD., Singapore


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou v Českom metrologickom inštitúte a odborným posúdením doplnku č. 1 zo dňa 24.10.1994 a doplnku č. 2 zo dňa 10.12.1995 Službami legálnej metrológie Slovenskej republiky Banská Bystrica.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohoto Rozhodnutia. Obsahuje 1 stranu a doplnky ČMI.

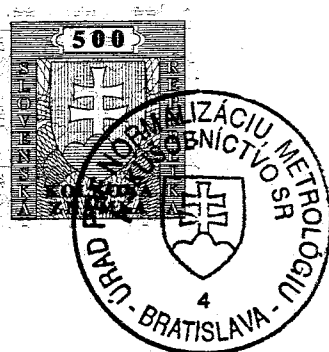


Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR


Typ meradla: váhy na počítanie kusov Digital Counting Scale,
model DC - 80

Výrobca: TERAOKA WEIGH-SYSTEM PTE. LTD., Singapore

Pre Slovenskú republiku platí Príloha zo dňa 26.9.1994 k doplnku
ČMI č.1 zo dňa 24.10.1994 a Príloha zo dňa 27.11.1995 k doplnku
ČMI č.2 zo dňa 10.12.1995 s nasledujúcimi zmenami:

1. Body 4. Údaje na meradle prílohy k doplnku č.1 a doplnku č.2
sa dopĺňajú textom:
"Všetky údaje na meradle musia byť v štátnom jazyku, medziná-
rodne používané skratky sú povolené.
2. Bod 6. Doba platnosti overenia prílohy k doplnku č.1 a doplnku
č.2:
Odvolávky na Výmer ÚNMaZ č.M-102/1993 a na Výmer ÚNMaZ
č.M-103/1994 sa nahrádzajú odvolávkou na Výmer FÚNM č.
M-101/91 zo dňa 21.10.1991.




Vypracoval: Ing. Jozef Tomko

Riaditeľ SLM SR MP Bratislava: Ing. Ladislav Hudoba

Riaditeľ SLM SR: Jozef Slamka



V Bratislave dňa 8.07.1996

ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT
Okružní 31 638 00 Brno

DOPLNĚK Č. 1

k rozhodnutí č. 1159/92/1 ze dne 17.4.1992

schválení typu měřidla

TCS 128/92 – 1159

Typ měřidla: váhy na počítání kusů DIGITAL COUNTING SCALE,
model DC - 80,
výrobce: Teraoka, Wigh-System PTE LTD., Singapore.

DOPLNĚK č. 1 je vydán na základě žádosti fy NOVUM spol.s r.o.
Praha. Předmětem doplňku je rozšíření rozhodnutí o schválení
typu měřidla takto:


modelová řada DC-80
s horní mezí váživosti 6 kg a 3 kg,
stejného výrobce.

Bližší podrobnosti tohoto rozhodnutí o doplňku jsou uvedeny
v příloženém protokolu ze dne 26. září 1994, který obsahuje
2 strany a je nedílnou součástí rozhodnutí o doplňku.

Platnost DOPLŇKU č. 1 k TCS 128/92-1159 je ode dne jeho vydání.
Ostatní údaje Rozhodnutí o schválení typu měřidla č. 1159/21/1
ze dne 17.4.1992 zůstávají v platnosti.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat u Úřadu pro technickou norma-
lizaci, metrologii a státní zkušebnictví rozklad do 15 dnů ode
dne jeho oznámení.



RNDr. Pavel K l e n o v s k ý
ředitel ČMI

Příloha

Brno, 24.10.1994

Příloha k Rozhodnutí č.1159/92/1

VÁHY NA POČÍTÁNÍ KUSŮ

DIGITAL COUNTING SCALE

MODEL DC - SO

(Rozšíření schválení)

Na žádost firmy NOVUM s.r.o. bylo provedeno rozšíření schválení typu měřidla - číslo typového schválení:

TCS 128/92-1159

Rozšíření se týká modelů DC-80 s horní mezí váživosti 6 kg a 3 kg .

1. Popis měřidla

Viz číslo typ. schválení TCS 128/92-1159.

2. Základní technické údaje

Horní mez váživosti (Max)	6 kg	3 kg
Dolní mez váživosti (Min)	20 g	10 g
Hodnota dílku (d)	1 g	0,5 g
Hodnota ověř. dílku (e)	1 g	0,5 g
Velikost táry (T)	- 6 kg	- 1 kg
Hodnota dílku táry (d)	1 g	0,5 g

3. Zkouška

Váhy byly přezkoušeny metodikou platnou pro zkoušení můstkových vah 3. třídy přesnosti ve smyslu ČSN 99 4102 a PNU 1256.2 . Zkoušky elektroniky byla provedena v rámci provozních podmínek používání.

4. Údaje na měřidle

Ověřeny byly údaje na měřidle udávané v gramech.
Ostatní údaje nepodléhají ověření.
Na štítku vah musí být uvedeny tyto údaje:

Třída přesnosti ve tvaru	III	III
Číslo typového schválení	TCS 128/92-1159	
Horní mez váživosti :	Max = 6 kg	Max = 3 kg
Dolní mez váživosti .	Min = 20 g	Min = 10 g
Hodnota dílku :	d = 1 g	d = 0,5 g
Hodnota ověř. dílku :	e = d = 1 g	e = d = 0,5 g
Výrobní číslo , rok výroby, typ vah		
Údaje o provozním napětí a frekvenci		
Teplotní rozsah použití		

TCS 128/92-1159

5.Ověření

Viz číslo typ. schválení TCS 128/92-1159.

6.Doba platnosti ověření

Doba platnosti ověření je stanovena Vyměrem UNMaZ
č.M-102/1993 na dva roky.

7.Umístění vzorku

Váhy výrobní číslo 170180 a 170213 byly vráceny firmě
NOVUM, sro. Praha 2, Vyšehradská 43.

Vypracoval: Lubomír Novák
ČMI-UI Praha



V Praze dne 26. září 1994

ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT
Brno



ROZHODNUTÍ
O SCHVÁLENÍ TYPU MĚŘIDLA

DOPLNĚK Č. 2

k rozhodnutí č. 1159/92/1 ze dne 17. 4. 1992
úřední značky schválení typu měřidla

TCS 128/92 – 1159

Typ měřidla: váhy na počítání kusů DIGITAL COUNTING SCALE,
model DC-80 s horní mezí váživosti 15 kg,
model DC-80 s horní mezí váživosti 6 kg a 3 kg,
výrobce: Teraoka, Weigh-System PTE LTD., Singapore.

DOPLNĚK č. 2 vydává Český metrologický institut Brno na základě žádosti firmy NOVUM, spol.s r.o. Praha 1.

Předmětem doplňku je rozšíření rozhodnutí o schválení typu měřidla kterým se schvaluje další modelová řada

model DC-80 s horní mezí váživosti 600 g.

Bližší údaje, technické a metrologické parametry jsou uvedeny v příloženém protokolu ze dne 27.11.1995, který obsahuje 2 strany a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí o doplňku.

Platnost Doplňku č. 2 k TCS 128/92 – 1159 je ode dne jeho vydání. Ostatní údaje Rozhodnutí č. 1159/92/1 o schválení typu měřidla ze dne 17. 4. 1992 zůstávají v platnosti.

P o u č e n í o o d v o l á n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat u Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení.



RNDr. Pavel Klenovský
ředitel ČMI

Příloha

Brno, 10. prosince 1995

Přípoha k rozhodnutí č.1159/92/1

VÁHY NA POČÍTÁNÍ KUSŮ
DIGITAL COUNTING SCALE
MODEL DC - 80

(Rozšíření schválení)

Na žádost firmy NOVUM s.r.o. bylo provedeno rozšíření schválení
typu měřidla - číslo typového schválení:

TCS 128 / 92 - 1159

Rozšíření o model DC-80 s horní mezí váživosti 600g.

1. Popis měřidla

Viz číslo typ. schválení TCS 128/92-1159

2. Základní technické údaje

Horní mez váživosti	(Max)	600g
Dolní mez váživosti	(Min)	2g
Hodnota dílku	(d)	0,1g
Hodnota ověřovacího dílku	(e)	0,1g
Velikost táry	(T)	-600g
Hodnota dílku táry	(d _t)	0,1g

3. Zkouška

Váhy byly přezkoušeny etalonovým závažím III.řádu a vyhovují
ČSN EN 45 501 pro váhy 3. třídy přesnosti.

4. Údaje na měřidle

Ověřeny byly údaje na měřidle uvedené v gramech.

Ostatní údaje nepodléhají ověření.

Na štítku vah musí být uvedeny tyto údaje:

Výrobce	TERAOKA WEIGH SYSTEM PTE.LTD SINGAPORE
Typ	DC-80
Výrobní číslo	
Třída přesnosti ve tvaru	<u>III</u>
Číslo typového schválení	TCS 128/92-1159
Horní mez váživosti (Max)	Max = 600g
Dolní mez váživosti (Min)	Min = 2g
Hodnota dílku (e=d)	e = d = 0,1g
Hodnota dílku táry (d _t)	d _t = 0,1g
Teplotní rozsah použití	-10 až +40°C
Údaje o provozním napětí a frekvence	220V / 50Hz

5.Ověření

Viz číslo typového schválení TCS 128/92-1159

6.Doba platnosti ověření

Doba platnosti ověření je stanovena Výměrem ÚNMZ č.M-103/1994 na dva roky.

7.Umístění vzorku

Váhy výrobní číslo 95200489 byly vráceny firmě NOVUM s.r.o.
Velehradská 23, Praha 3, 130 00.

Vypracoval: Novák Lubomír ČMI-OI Praha

Datum provedení: 27.11.1995

Počet stran: 2 (dvě)



ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT
Oblastní inspektorát Praha
Radiová 3
102 00 PRAHA
2