

SLUŽBY LEGÁLNEJ METROLÓGIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Hviezdoslavova 31, 975 90 Banská Bystrica
Metrologické pracovisko Bratislava

DODATOK č.1 zo dňa 28.03.1995 k Rozhodnutiu č. 960/128/93-023 zo dňa 7.6.1993 s úradnou značkou schváleného typu meradla

TSQ 128/93-023

Na žiadosť Slovenských elektrotechnických závodov Krompachy, a.s., Hornádska č.1, 053 42 Krompachy, Služby legálnej metrológie SR vydávajú podľa § 6 Zákona č. 505/1990 Zb. DODATOK č.1 k Rozhodnutiu č. 960/128/93-023 zo dňa 7.6.1993 o schválení typu meradla TSQ 128/93-023.

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla pre plošinové váhy typového radu H, typ H 400 prevedenia P1, P2, P4 a P5 a typ H 600 prevedenia P1, P2, P4 a P5 v súlade s prílohou.

Výrobca: Slovenské elektrotechnické závody Krompachy, a.s.
Hornádska č.1
053 42 Krompachy

Platnosť Dodatku č. 1 končí dňom 07.06.2003.

Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky ako bolo zistené technickou skúškou vykonanou našou organizáciou.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Príloha v rozsahu dvoch strán je neoddeliteľnou súčasťou tohoto dodatku.




Jozef Slamka
riaditeľ SLM SR

Typ meradla: plošinové váhy typového radu H, typ H 400 prevedenia P1, P2, P4 a P5 a typ H 600 prevedenia P1, P2, P4 a P5

Výrobca: Slovenské elektrotechnické závody Krompachy, a.s.
Hornádska č.1, 053 42 Krompachy

Týmto dodatkom sa rozširuje schválenie typu plošinových váh typového radu H o prevedenia P6, P7, P8 a P9 typu H 400 a o prevedenia P0 a P3 typu H 600, ako aj o vyhodnocovacie jednotky typu L 115 a L116.

Predmetom dodatku sú nasledujúce zmeny a doplnky:

1.Príloha k schváleniu typu meradla TSQ 128/93-023, Bod 2.Popis meradla, časť Zobrazovacia jednotka sa dopĺňa textom:

- môže byť typu L 115 alebo L 116, pričom typ L 116 je vyhotovená v krytí IP 65 a v závesnom prevedení. Indikácia podmienok váženia a zobrazovanie výsledkov váženia sú realizované pomocou LCD displeja. Typ L 115 môže byť vybavený integrovanou tlačiarňou, údaje tlačiarne však nie sú predmetom overenia.

2.Príloha k schváleniu typu meradla TSQ 128/93-023, Bod 3.Základné metrologické a technické údaje sa dopĺňa tabuľkou:

typ/prevedenie	H400/P6	H400/P7	H400/P8
vonk.rozмеры(mm)	1000x1000x90	1000x1000x90	1250x1000x90
horná medza			
váživosti (kg)	800	1500	800
dolná medza			
váživosti (kg)	4	10	4
hodnota over.			
dielika (kg)	0.2	0.5	0.2
hodnota digit.			
dielika (kg)	0.2	0.5	0.2
počet dielikov	4000	3000	4000
typ snímača	8713/500 kg	8713/500 kg	8713/500 kg

typ/prevedenie	H400/P9	H600/P0	H600/P3
vonk.rozмеры(mm)	1250x1000x90	1290x840x83	1290x990x83
horná medza			
váživosti (kg)	1500	300	600
dolná medza			
váživosti (kg)	10	2	4
hodnota over.			
dielika (kg)	0.5	0.1	0.2
hodnota digit.			
dielika (kg)	0.5	0.1	0.2
počet dielikov	3000	3000	3000
typ snímača	8713/500 kg	8713/125 kg	8713/125 kg



3.Príloha k schváleniu typu meradla TSQ 128/93-023, Bod 5. Údaje na meradle, odsek horná medza váživosti sa dopĺňa o hodnotu:

Max=300 kg


4.Príloha k schváleniu typu meradla TSQ 128/93-023, Bod 6. Overenie sa dopĺňa textom:

Vyhodnocovacia jednotka L 115 sa overí vyrazením overovacích značiek na vložky overovacieho štítu umiestnenom na boku jednotky, nanesením overovacieho štítu cez štítok SEAL ktorý prekrýva skrutku spájajúcu vrchný a spodný kryt jednotky, plombou na lanku cez konektory káblov spájajúce snímače s vyhodnocovacou jednotkou a plombou na lanku cez dve skrutky konektora od snímačov.

Vyhodnocovacia jednotka L 116 sa overí vyrazením overovacích značiek na vložky overovacieho štítu umiestnenom na boku jednotky, vyrazením overovacích značiek do vložiek v miskách nad dvomi skrutkami pripevňujúcimi vrchný kryt jednotky a plombou na lanku cez konektor kábla od snímačov a skrutku v telese jednotky.

Vyhotovenie jednotiek musí byť tzv. totally secure, t.j. pájkovacia plocha na hlavnej doske plošného spoja jednotky musí byť rozpojená (viď. Obrázok č. 1).

Ostatné údaje rozhodnutia č. 960/128-023 zo 7.6.1993 zostávajú v platnosti. Váhy musia zodpovedať dokumentácii predloženej ku skúške, ktorá je uložená na SLM SR MP Bratislava.

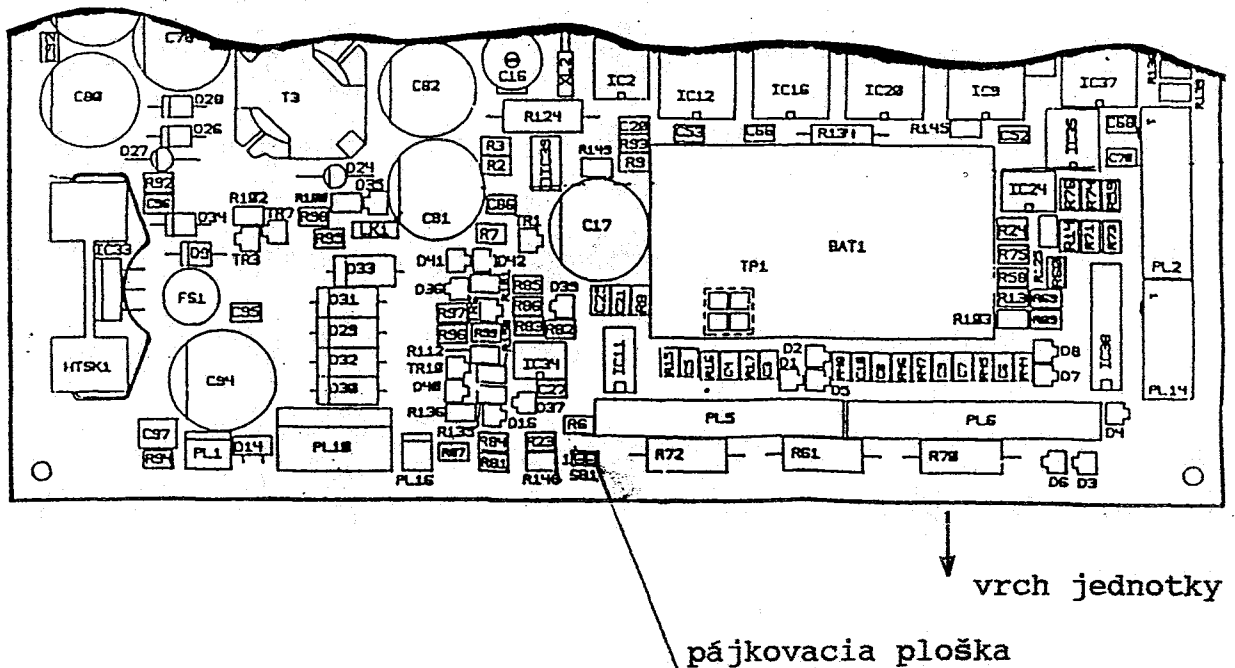

Obrázok č. 1

Skúšku vykonal: Ing. Jozef Tomko

Ing. Ladislav Hudoba
riaditeľ MP

V Bratislave, 28.03.1995

